# DISTORTION ANALYZER CS 27 E

1/2

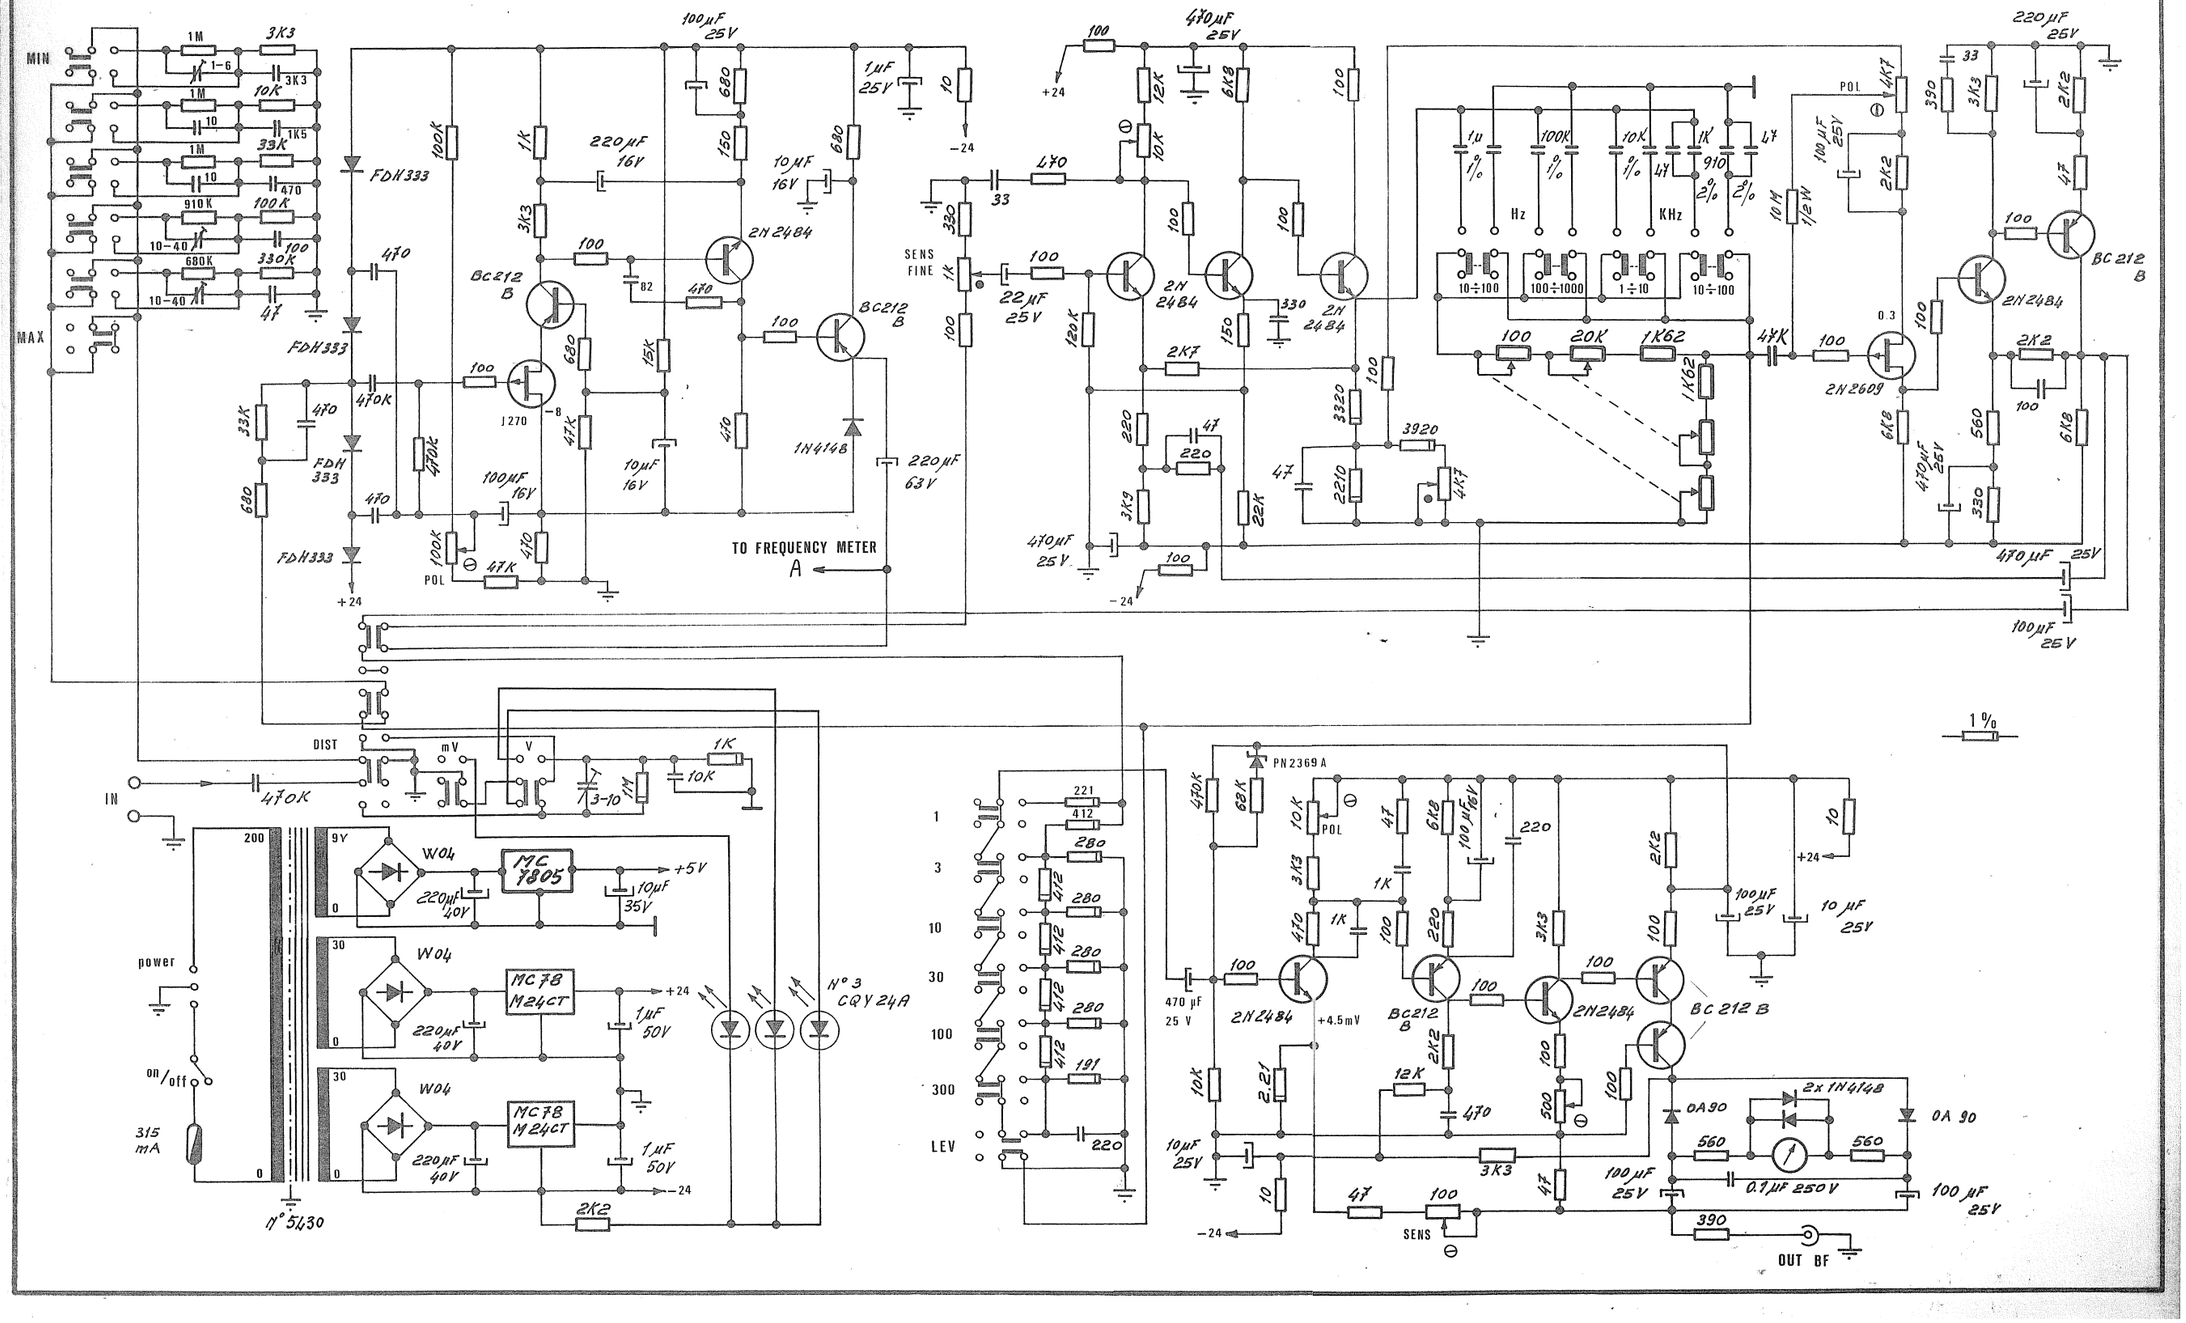

# CS 27E DISTORTION METER

## DIGITAL FREQ DPM 10/B

40µH
0.1µF
0.33µF
ZERO ADJ
10K
100K
100K
KHz
CQY24
Hz
470
470K
1M
100K MONOC.
0.1µF
A
2k2
1K
SENS ADJ
CA 3162E
CA 3161E
BD 370
BD 370
BD 370
HP 5082 7730
220
220
+5
+24
TO DISTORTION METER
A
10K
2X1N4148
10µF 22V
Hz 10÷100
Hz 100÷1000
KHz 1÷10
KHz 10÷100
4X1N4148
470K
100K
220K
22K
10K
8k2
1N4148
10K
2k2
CA3140E
CA 4518
CA4518
CD4066
LM 2917J
10K
22K
100K
1V=999Hz ADJ
22K
100K
300K
22
22K
100K
-24
0.1V=100Hz ADJ