

Ein Ionen-Laser für metrologische Anwendungen

E. ENGELHARD und F. SPIEWECK

Mitteilung aus der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt
Braunschweig

(Z. Naturforsch. 25 a, 156 [1970]; eingeg. am 17. Dezember 1969)

A xenon isotop laser has been built which emits Xe(II)-lines in the visible. The vapour pressure controlled laser tube operates at low current. Preliminary vacuum wavelength values have been found to be $(542.065\ 49 \pm 0.000\ 02)$ nm and $(627.254\ 64 \pm 0.000\ 01)$ nm.

Für metrologische Anwendungen wurde ein Laser entwickelt, der mehrere Linien im sichtbaren Spektralbereich emittiert. Das Laser-Rohr ist gefüllt mit dem Nuklid ^{136}Xe von einigen Torr Druck. Ein Zweig des Laser-Rohrs wird in siedendem Sauerstoff gekühlt, so daß sich der Sättigungsdruck des Xenons von etwa 45 mTorr einstellt. Daher sind die internen Bedingungen des Laser-Rohrs und somit die Wellenlängen stabil. Die wassergekühlte Kapillare aus Solidex-Glas hat einen Durchmesser von nur etwa 1 mm, so daß der Entladungsstrom und damit die Einflüsse von Stark- und Zeeman-Effekt klein bleiben. Zwischen dem Anoden- und dem Kathodenteil, die eine zylindrische Anode bzw. eine Glühkathode enthalten, befindet sich eine Gasrückführleitung¹ (s. Abb. 1).

Bei Verwendung breitbandiger dielektrischer Laser-Spiegel wurde die Emission einer roten ($6p'\ ^2\text{F}_{5/2} - 6s'\ ^2\text{D}_{3/2}$, $\lambda = 627$ nm) und einer grünen ($6p'\ ^4\text{D}_{5/2} - 6s'\ ^4\text{P}_{3/2}$, $\lambda = 542$ nm) Xe(II)-Linie^{2, 3} beobachtet. Je nach Stärke des Entladungsstromes erscheinen bei einem Spiegelabstand von 43 cm ein bis fünf⁴ axiale Eigenschwingungen bei konfokaler Anordnung der Spiegel. Die Wellenlängen wurden zunächst im Betrieb mit drei Eigenschwingungen gemessen. Hierzu wurde der Abstand der Laser-Spiegel piezoelektrisch so eingestellt, daß die beiden äußerer mit Hilfe eines Fabry-Perot-Etalons feststellbaren Eigenschwingungen dem Auge gleich hell erschienen. Die Sichtbarkeit der Interferenzen erwies sich bei einem Gangunterschied von 1 m als völlig unbeeinträchtigt. Die an verschiedenen

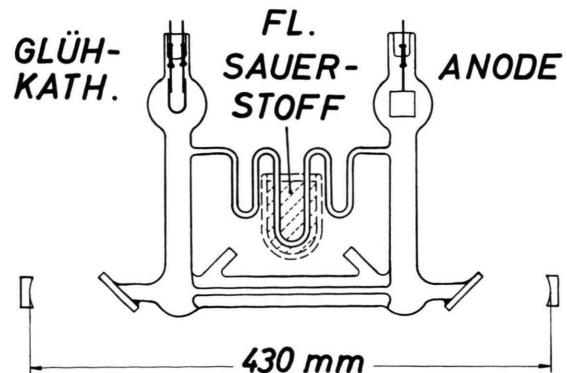


Abb. 1. Xenon-Ionen-Laser, schematisch.

Laser-Rohren und bei unterschiedlichen Entladungsstromstärken (1,3 A bis 2,2 A) ermittelten Wellenlängenwerte betragen $(542,065\ 49 \pm 0,000\ 02)$ nm und $(627,254\ 64 \pm 0,000\ 01)$ nm (Unsicherheitsangaben: einfache Standardabweichung).

Eine Abhängigkeit der Wellenlängen von Druck und Stromstärke konnte nicht festgestellt werden⁵. Angestrebt wird der Bau eines Einfrequenz-Lasers mit einer Emission bei den drei Wellenlängen 460 nm, 542 nm und 627 nm. Dies wäre wichtig für die metrologische Anwendung der Koinzidenzmethode zur Bestimmung der Ordnungszahl von Interferenzen.

Unseren Mitarbeitern, den Herren WÜRTELE, DARNEDE und WESSELHÖFT, sind wir zu großem Dank verpflichtet für die Herstellung der Laser-Spiegel und für die sorgfältigen Messungen der Wellenlängen. Herr O. SCHMIDT hat sich großes Verdienst erworben bei der Lösung von schwierigen glastechischen Aufgaben.

¹ E. I. GORDON u. E. F. LABUDA, Bell Syst. Tech. J. **43**, 1827 [1964].

² W. B. BRIDGES, Proc. IEEE **52**, 843 [1964].

³ E. F. LABUDA u. A. M. JOHNSON, IEEE J. Quant. Electron. **QE-2**, 700 [1966].

⁴ A. L. BLOOM, R. L. BYER u. W. E. BELL, Phys. Quant. Electron. (Confer. Proc.) Ed. P. L. KELLEY, B. LAX u. P. E. TANNENWALD, McGraw-Hill, 688 [1966].

⁵ Der Druck wurde bisher nur bei den Wellenlängenbestimmungen der roten Linie variiert.

Nachdruck — auch auszugsweise — nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages gestattet
Verantwortlich für den Inhalt: A. KLEMM
Satz und Druck: Konrad Tritsch, Würzburg



Dieses Werk wurde im Jahr 2013 vom Verlag Zeitschrift für Naturforschung in Zusammenarbeit mit der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. digitalisiert und unter folgender Lizenz veröffentlicht: Creative Commons Namensnennung-Keine Bearbeitung 3.0 Deutschland Lizenz.

Zum 01.01.2015 ist eine Anpassung der Lizenzbedingungen (Entfall der Creative Commons Lizenzbedingung „Keine Bearbeitung“) beabsichtigt, um eine Nachnutzung auch im Rahmen zukünftiger wissenschaftlicher Nutzungsformen zu ermöglichen.

This work has been digitized and published in 2013 by Verlag Zeitschrift für Naturforschung in cooperation with the Max Planck Society for the Advancement of Science under a Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Germany License.

On 01.01.2015 it is planned to change the License Conditions (the removal of the Creative Commons License condition "no derivative works"). This is to allow reuse in the area of future scientific usage.